

Raport pomiaru

Indeks pomiaru:275
Tryb:Normalny




TOS-1064
V2.01.159.0

Wynik: Brak dopasowania
Substancja chemii: Niewykryty
HQI: N/A
Synonimy: N/A
CAS#: N/A
Klasyfikacja: N/A

Walidacja: Powodzenie(2021/05/31
07:42:27 CEST)
Minimalne HQI: 60
Wersja TOS: 2.01.159.0
SN Urządzenia: DAAERK
Nazwa konta: ADMIN
Czas pomiaru: 2021/05/31 07:44:16
CEST
Czas integracji: 1ms
Moc lasera: 100%
Dopasowane w
bibliotece: N/A
Przeszukane
biblioteki: BWTek_CNESP,
BWTek_D, BWTek_TPJ

Notatki: N/A

Próbka: _____

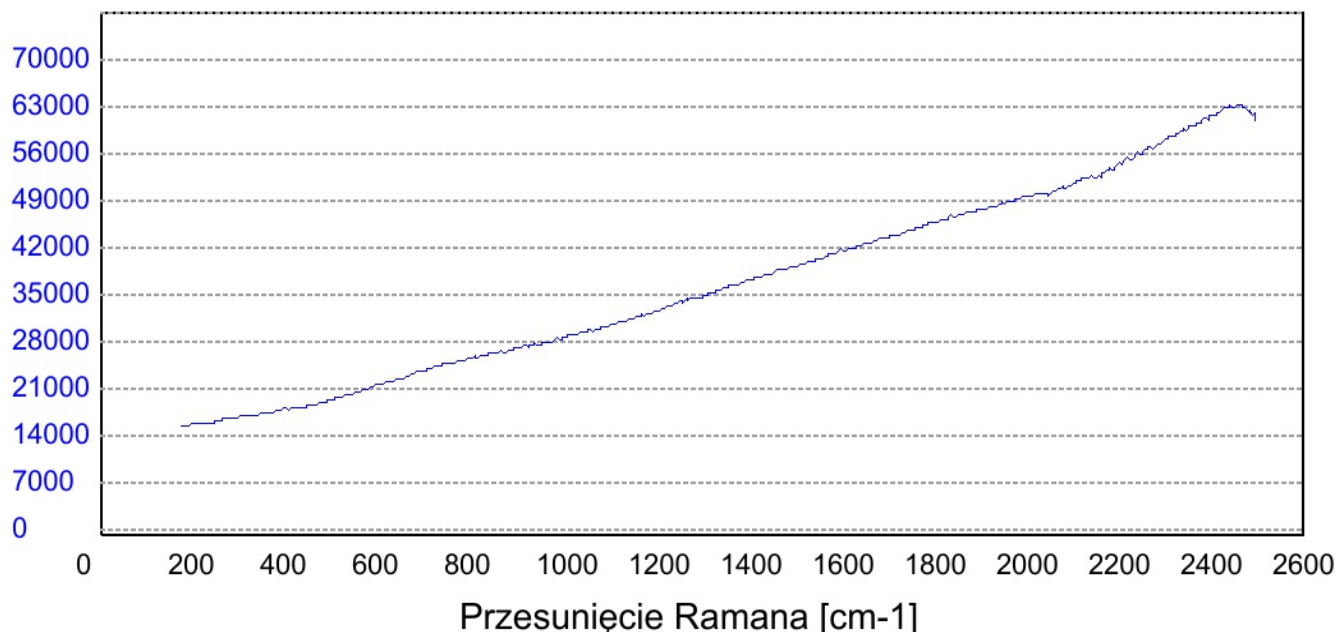

Raport pomiaru

Indeks pomiaru:275

Tryb:Normalny

